


# Reservdelar Medicinska gasuttag

Gasuttagen är normalt sett underhållsfria. Dock kan det vara nödvändigt att byta o-ringar eftersom de utsätts för normalt slitage (Byte av o-ring sker vid behov, dock minst vart 3:e år). Byte av dessa kan utföras under tryck, förutsatt att serviceventil ingår, denna blockerar flödet under bytet. De delar som är utbytbara tillhandahåller vi som kompletta reservdelssatser eller enstaka komponenter. Vid beställning anges förutom artikelnummer även vilken gastyp som satsen avser.

## Kompletta reparationsset

## Artikel

## Beställningsnummer

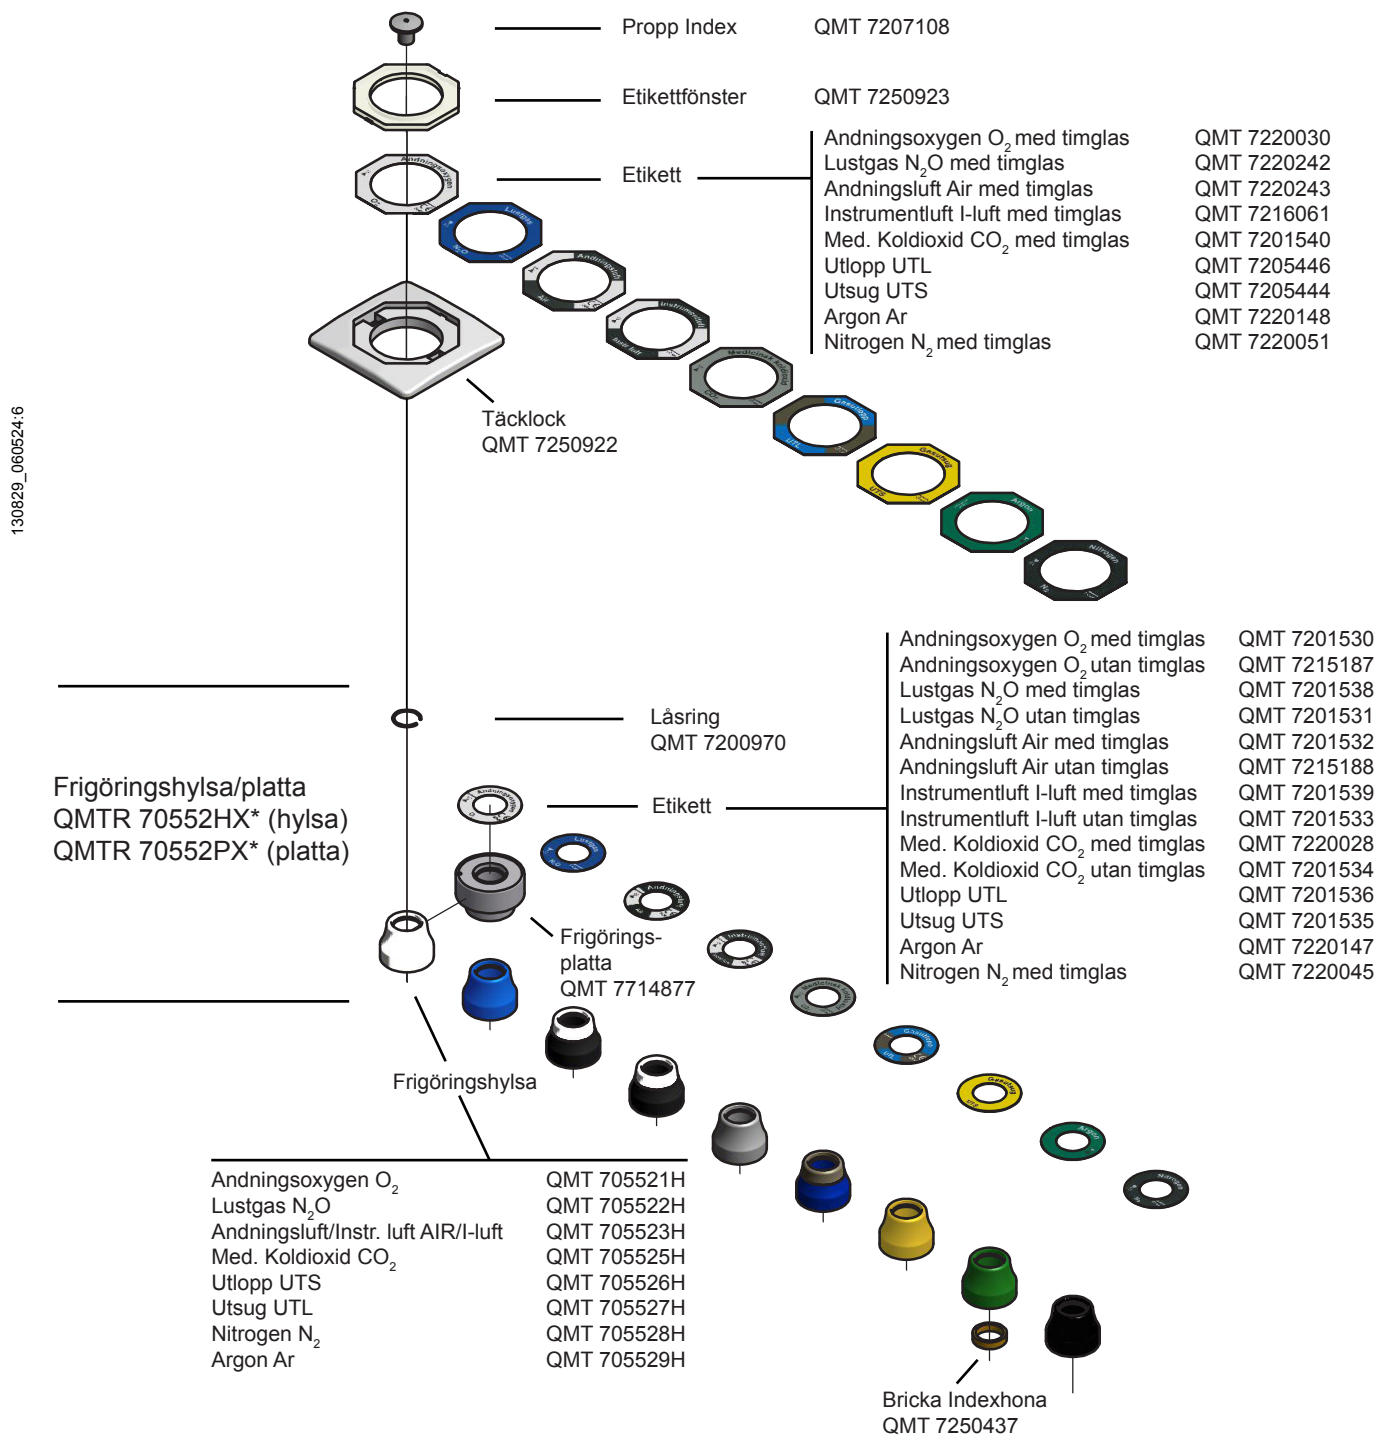

\*X anger gassort 1=O<sub>2</sub>, 2=N<sub>2</sub>O, 3=AIR, 4=I-luft, 6=UTS, 7=UTL, 8=N<sub>2</sub>, 9=Ar


Fortsättning på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.

### Kompleta reparationsseter

### Artikel

### Best. nr.

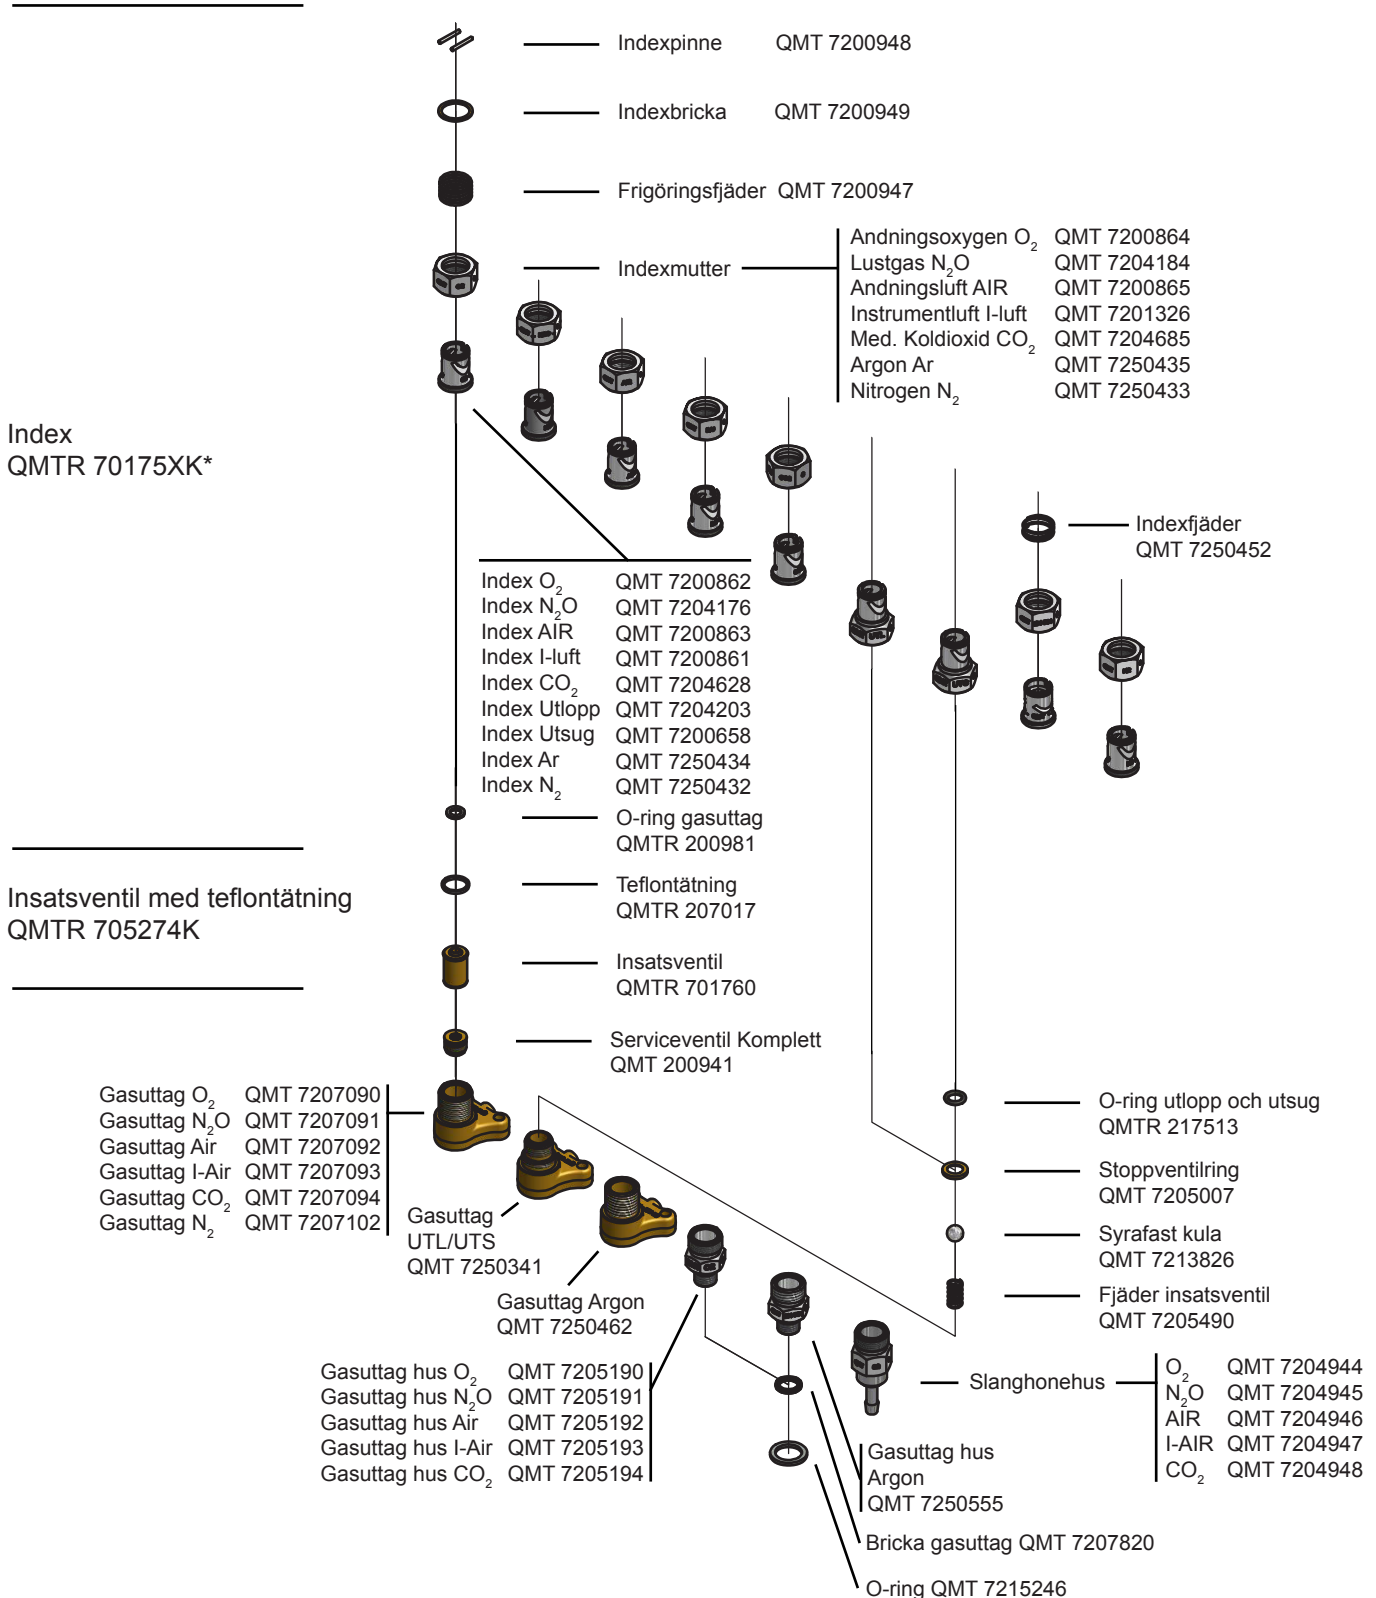

\*X anger gassort 1=O<sub>2</sub>, 2=N<sub>2</sub>O, 3=AIR, 4=I-luft, 6=UTS, 7=UTL, 8=N<sub>2</sub>, 9=Ar