


Qmt MasterWatch5 050 Standard


För korrekt funktion skall
nedanstående vara uppfyllt:
24 V DC $\pm 10\%$
Max restrippel 200 mV P-P

Kablarna får ej demonteras!



-X1= Strömförsörjning
-X2= Signalkabel
-X3= Modbus kabel

Customer: Qmt Tech AB		Project title: QMT Masterwatch5 050 Standard, utgåva11	
Filename: Masterwatch5_050 Kabel		Page title: Anslutning: Tryckövervakare kabel	
	Order no.:		Page 1
	Project no.:		Scale: 1:1
	Constructor: Christoffer Rathjen		Previous page:
	Appr. by: Vesa Ronkainen		Next page: 2
Last correction: 2013-10-30		Appr. date: 2013-10-30	Number of pages: 2

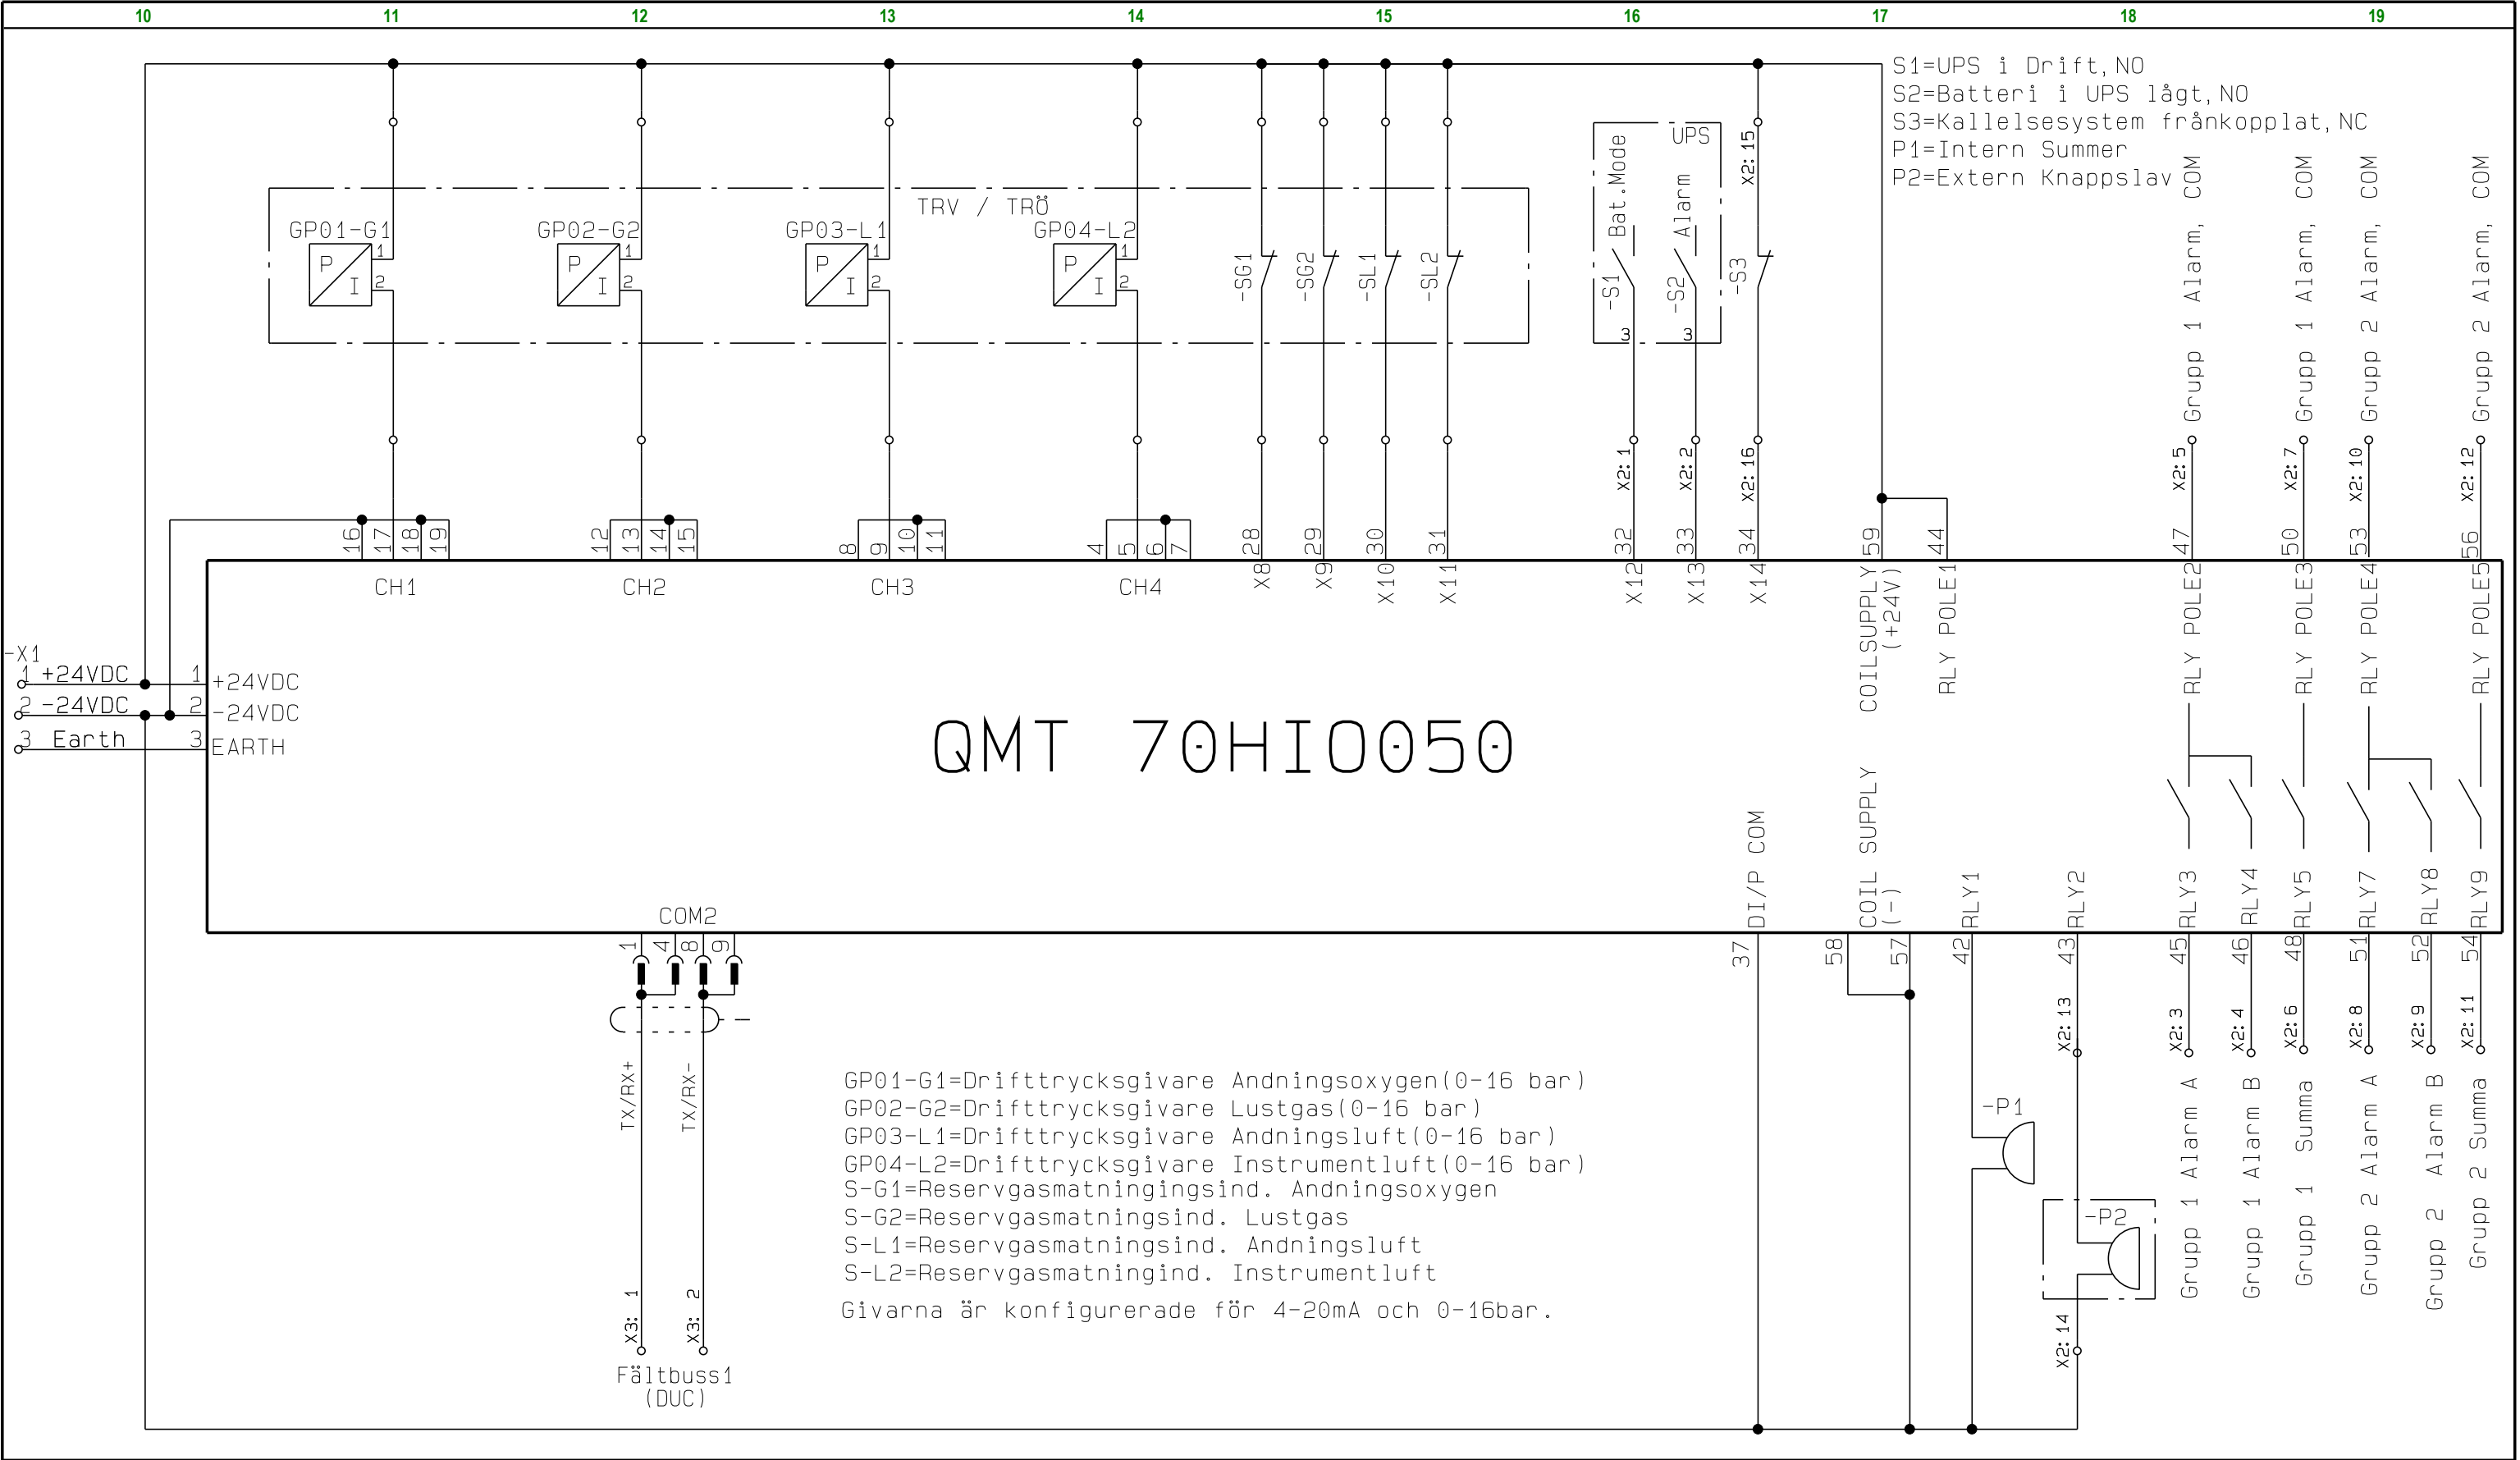

	Project title: QMT Masterwatch5 050 Standard, utgåva11	Order no.:	Page 2
	Customer: Qmt Tech AB	Project no.:	Scale: 1:1
	Page title: Tryckövervakare kabel	Constructor: Christoffer Rathjen	Previous page: 1
	Filename: Masterwatch5_050 Kabel	Appr. by: Vesa Ronkainen	Next page:
	Last correction: 2013-10-30	Appr. date: 2013-10-30	Number of pages: 2